


-20°C

902-臨床試驗中心-(下)溫度紀錄表

月份: 2019/1

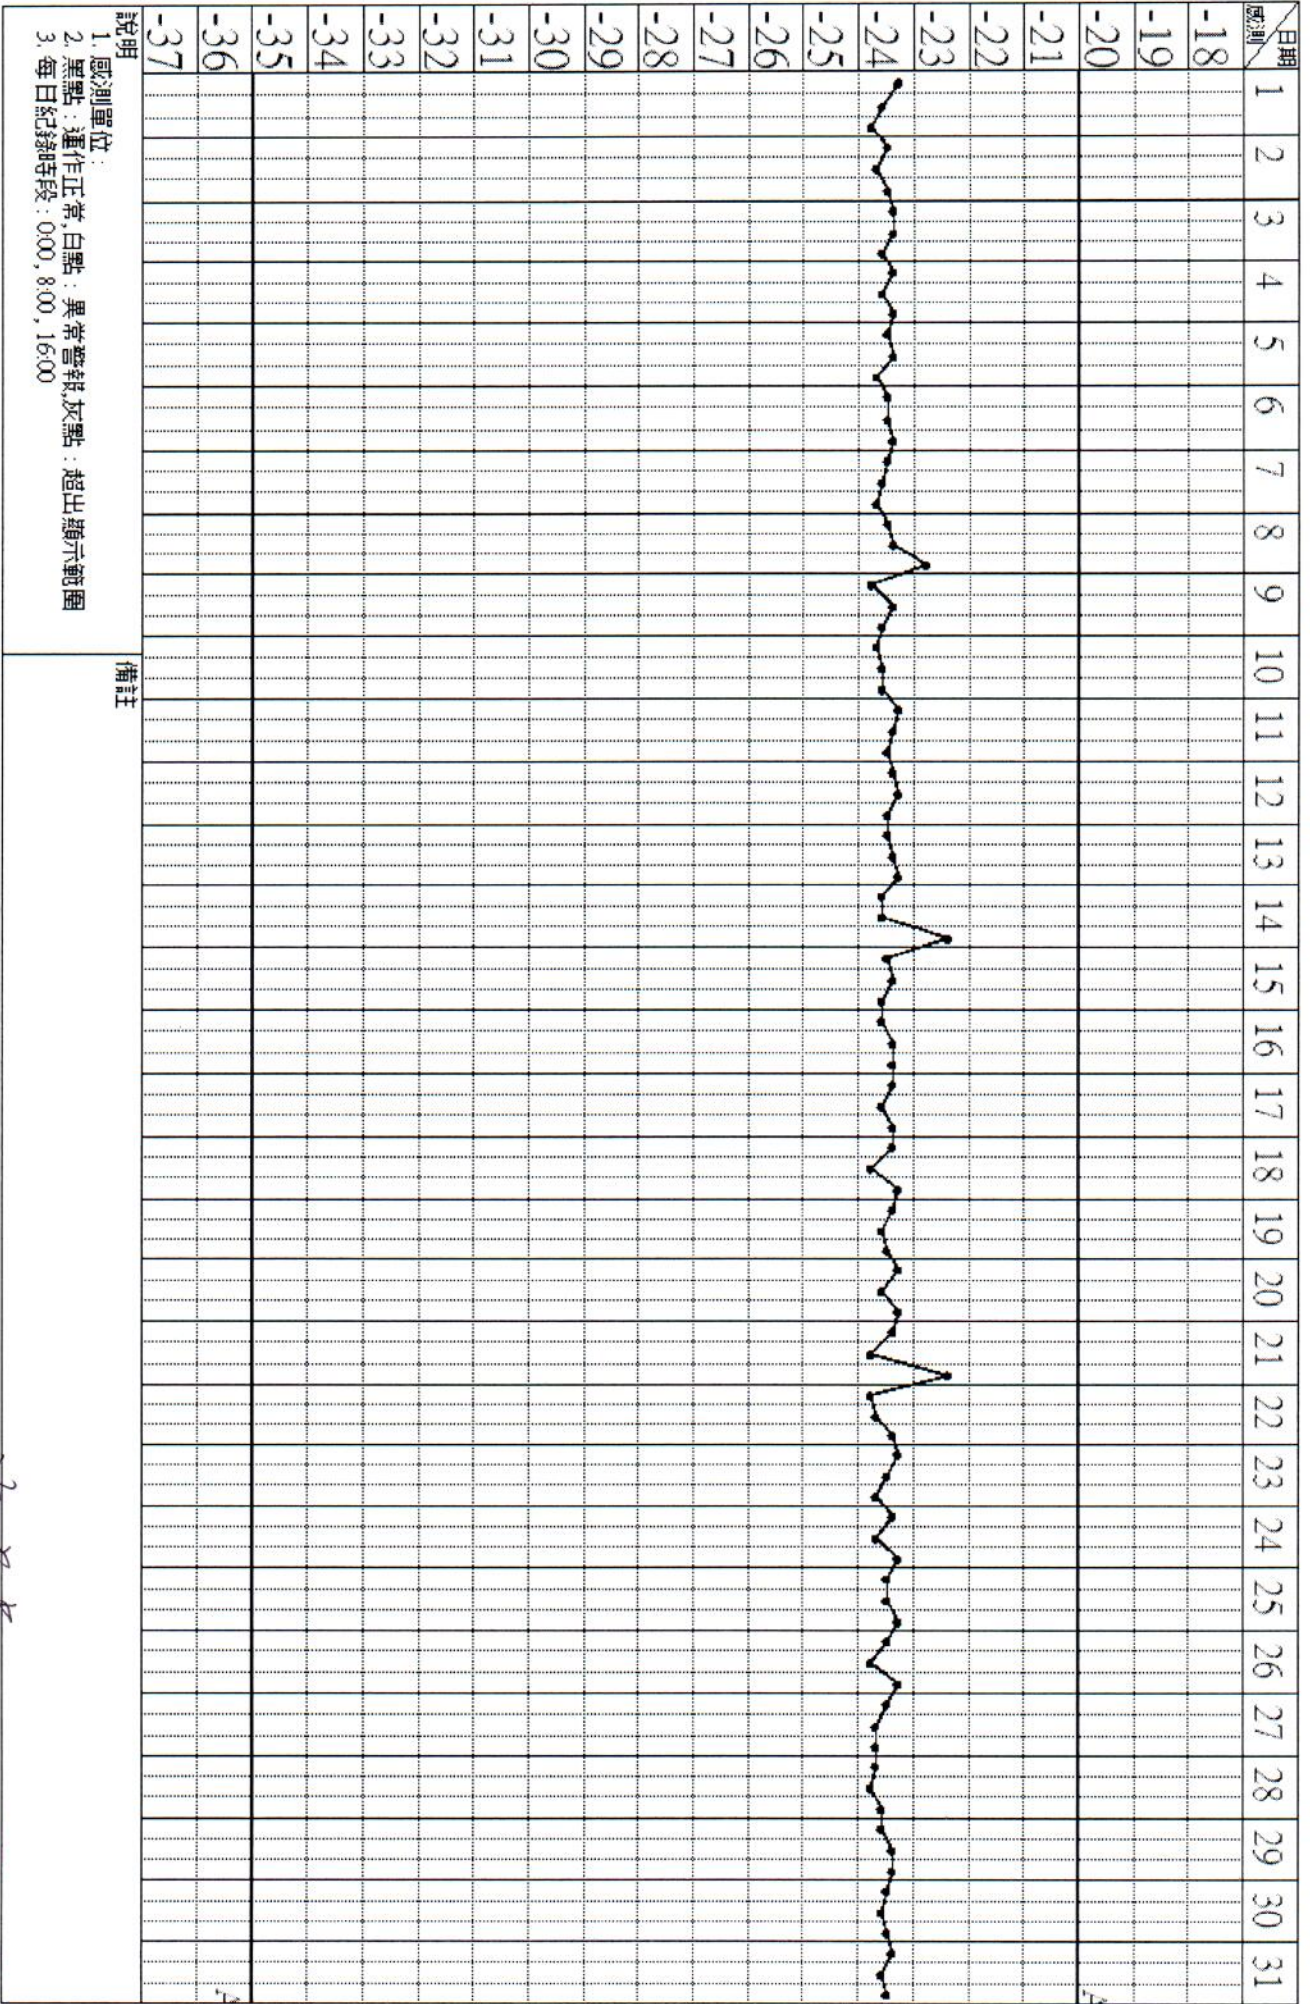

- 說明
- 1. 感測單位:
 - 2. 黑點: 運作正常, 白點: 異常警報, 灰點: 超出顯示範圍
 - 3. 每日紀錄時段: 000, 8:00, 16:00

備註

列印日期: 2019/02/01 10:11:02

單位主管:

Signature

製表者:

黃子馨 2019 Feb 21

11- Feb-2019