


-20°C

902-臨床試驗中心-(下)溫度紀錄表

月份: 2019/2

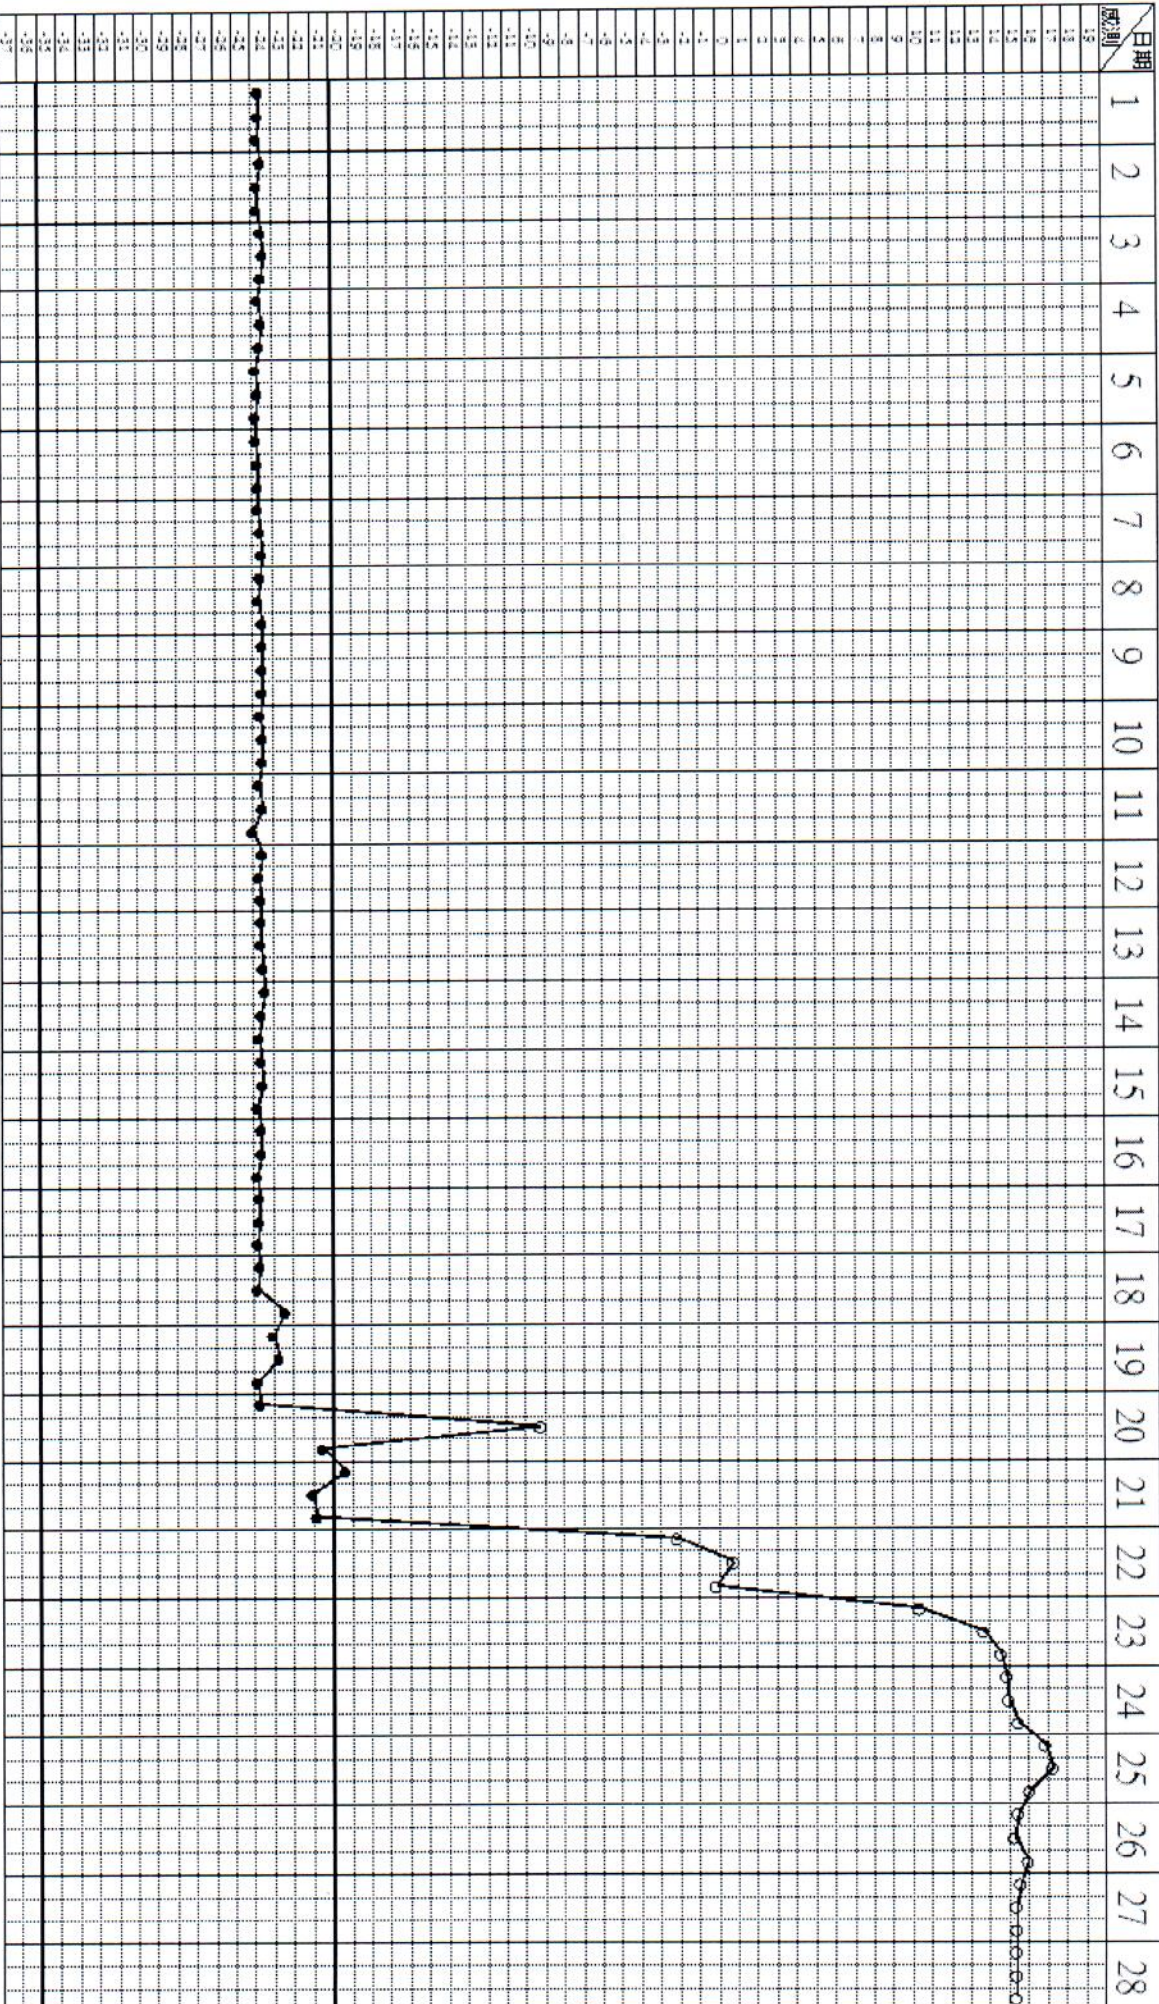

說明

- 1. 感測單位:
- 2. 黑點: 運作正常 白點: 異常警報 灰點: 超出顯示範圍
- 3. 每日紀錄時段: 0:00, 8:00, 16:00

備註

左故障待修中。

列印日期: 2019/03/01 09:48:38

單位主管:  黃于晏 04.MAR.2019

製表者: 黃于晏 01.MAR.2019