


點位：	902-臨床試驗中心-(下)電話:3933	時間：	2020-03-01 00:00:00 - 2020-03-31 23:59:59
-----	-----------------------	-----	---

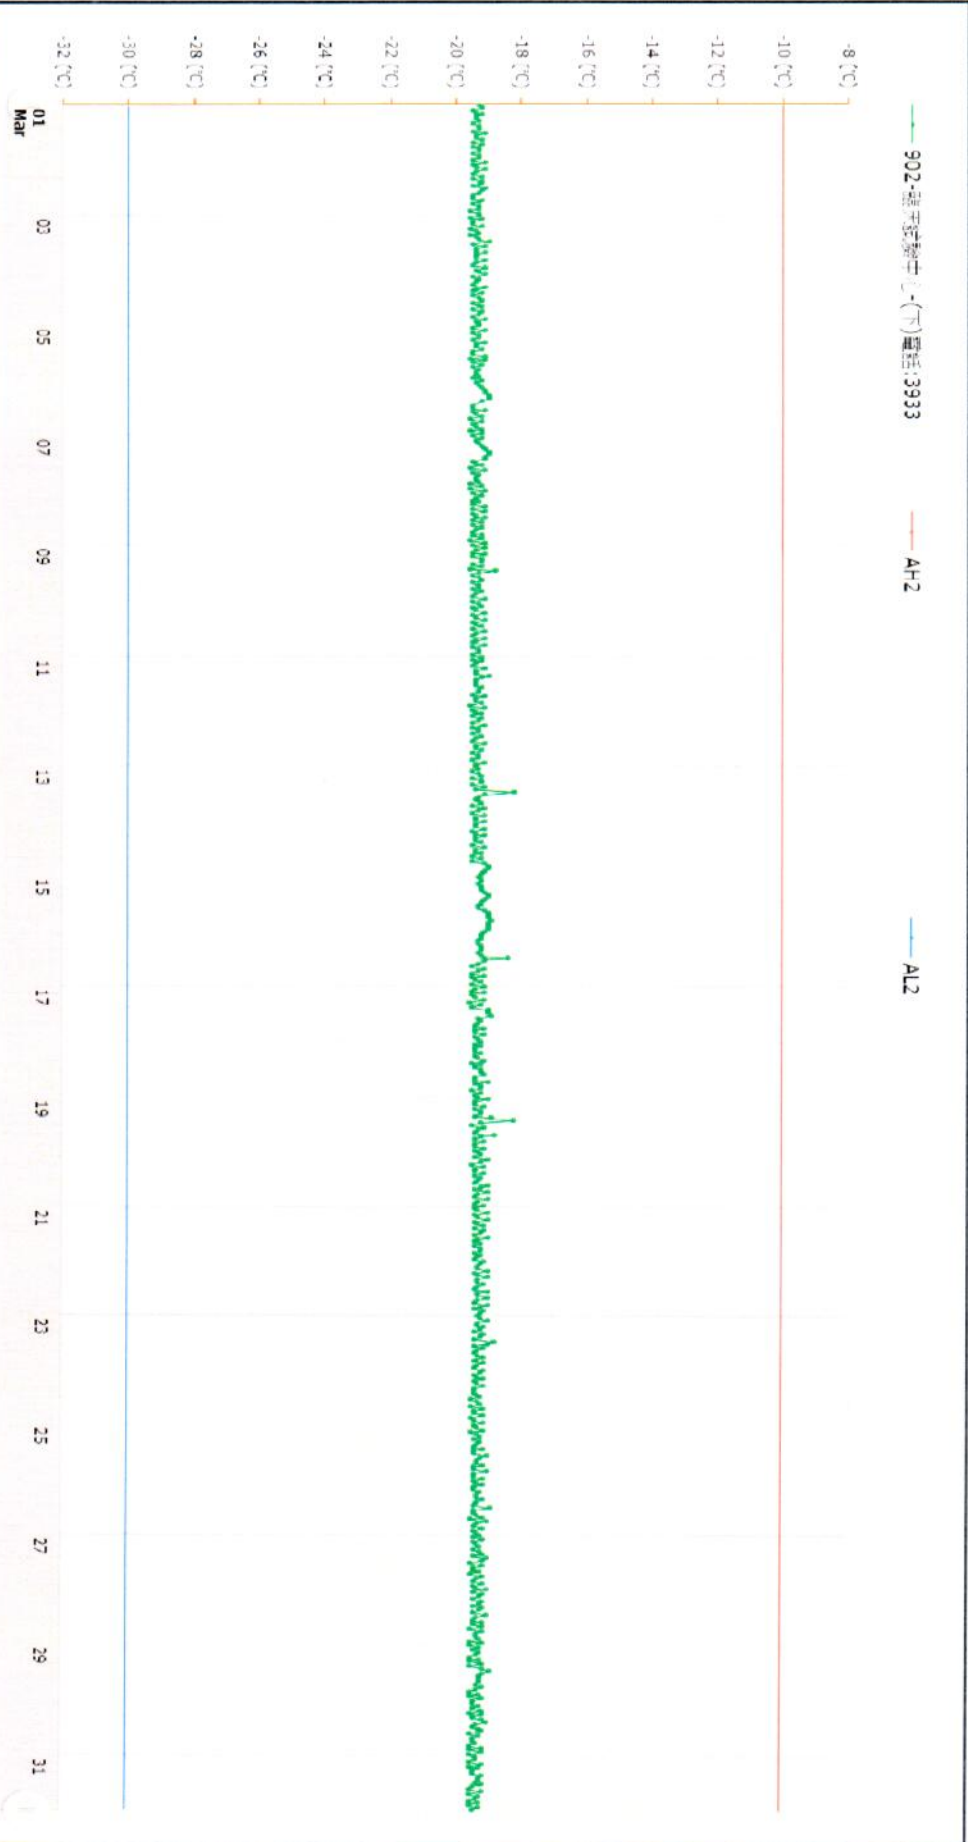

列印時間：	2020-04-01 09:10:10	單位主管：	許敬賢	製表者：	黃子馨
			2020. APR. 02 01		01. APR. 2020