


點位：

902-臨床試驗中心-(下)電話:3933

時間：

2020-10-01 00:00:00 - 2020-10-31 23:59:59

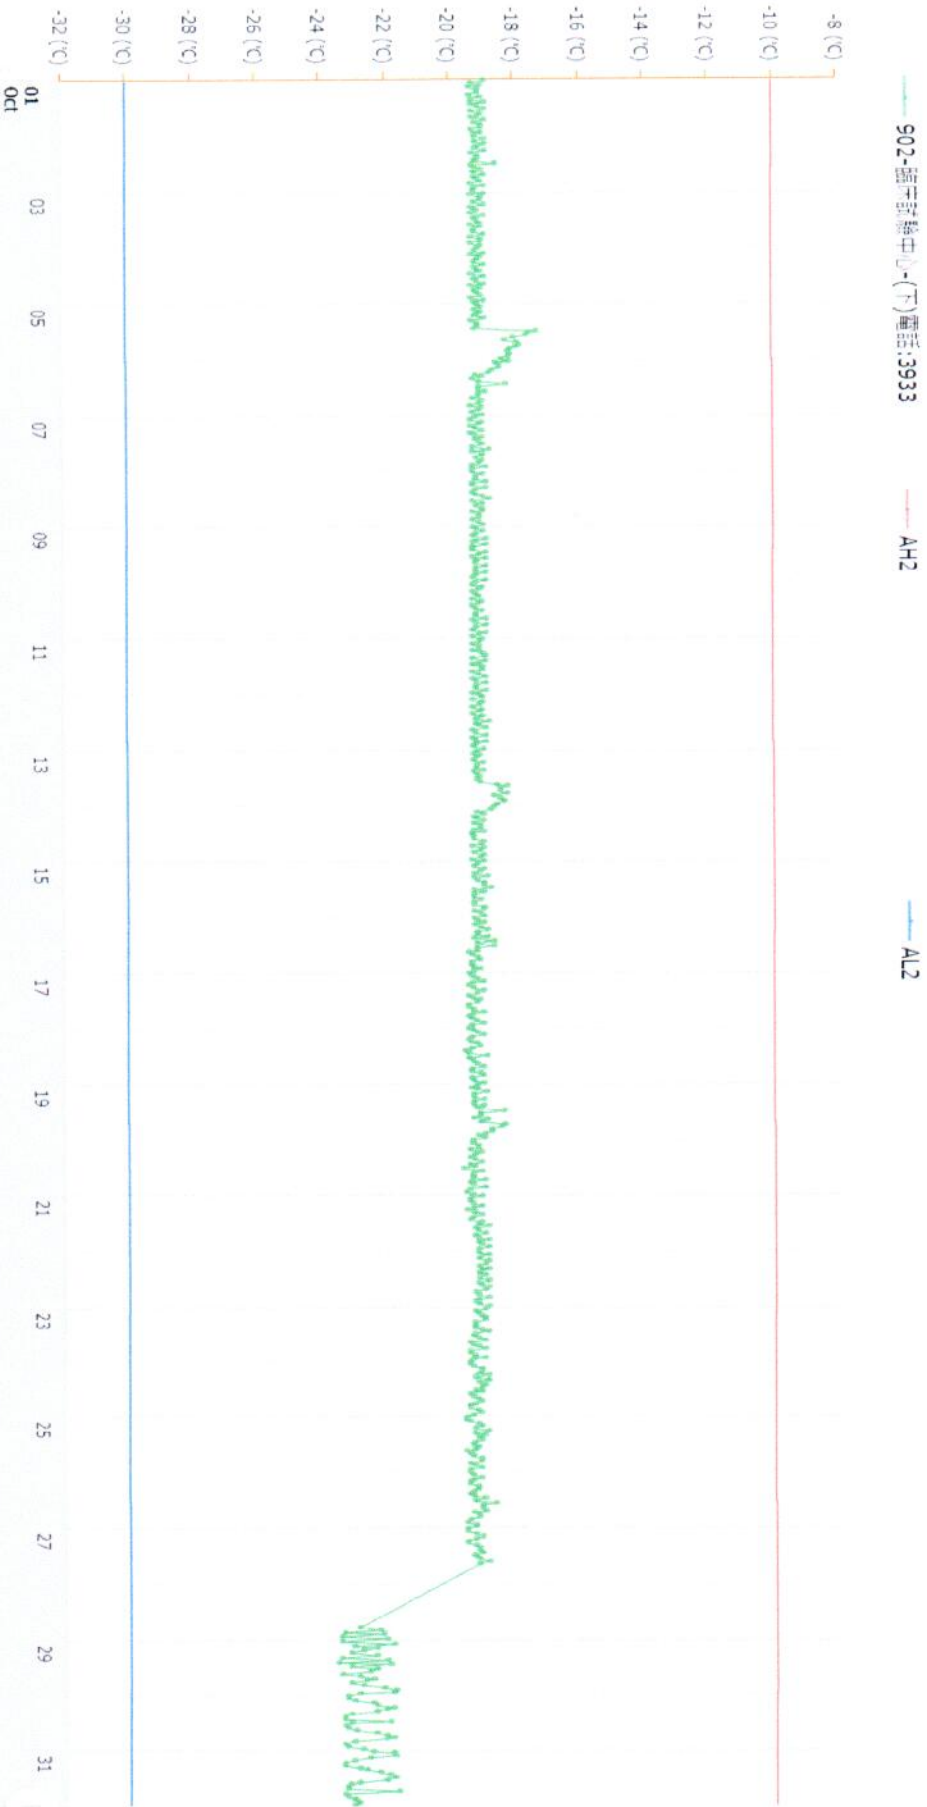

列印時間：

2020-11-02 10:38:24

單位主管：

許潔貞
2020.11.06

製表者：

黃子馨
2020.11.2