


點位：

902-臨床試驗中心-(下)電話:3933

時間：

2020-12-01 00:00:00 - 2020-12-31 23:59:59

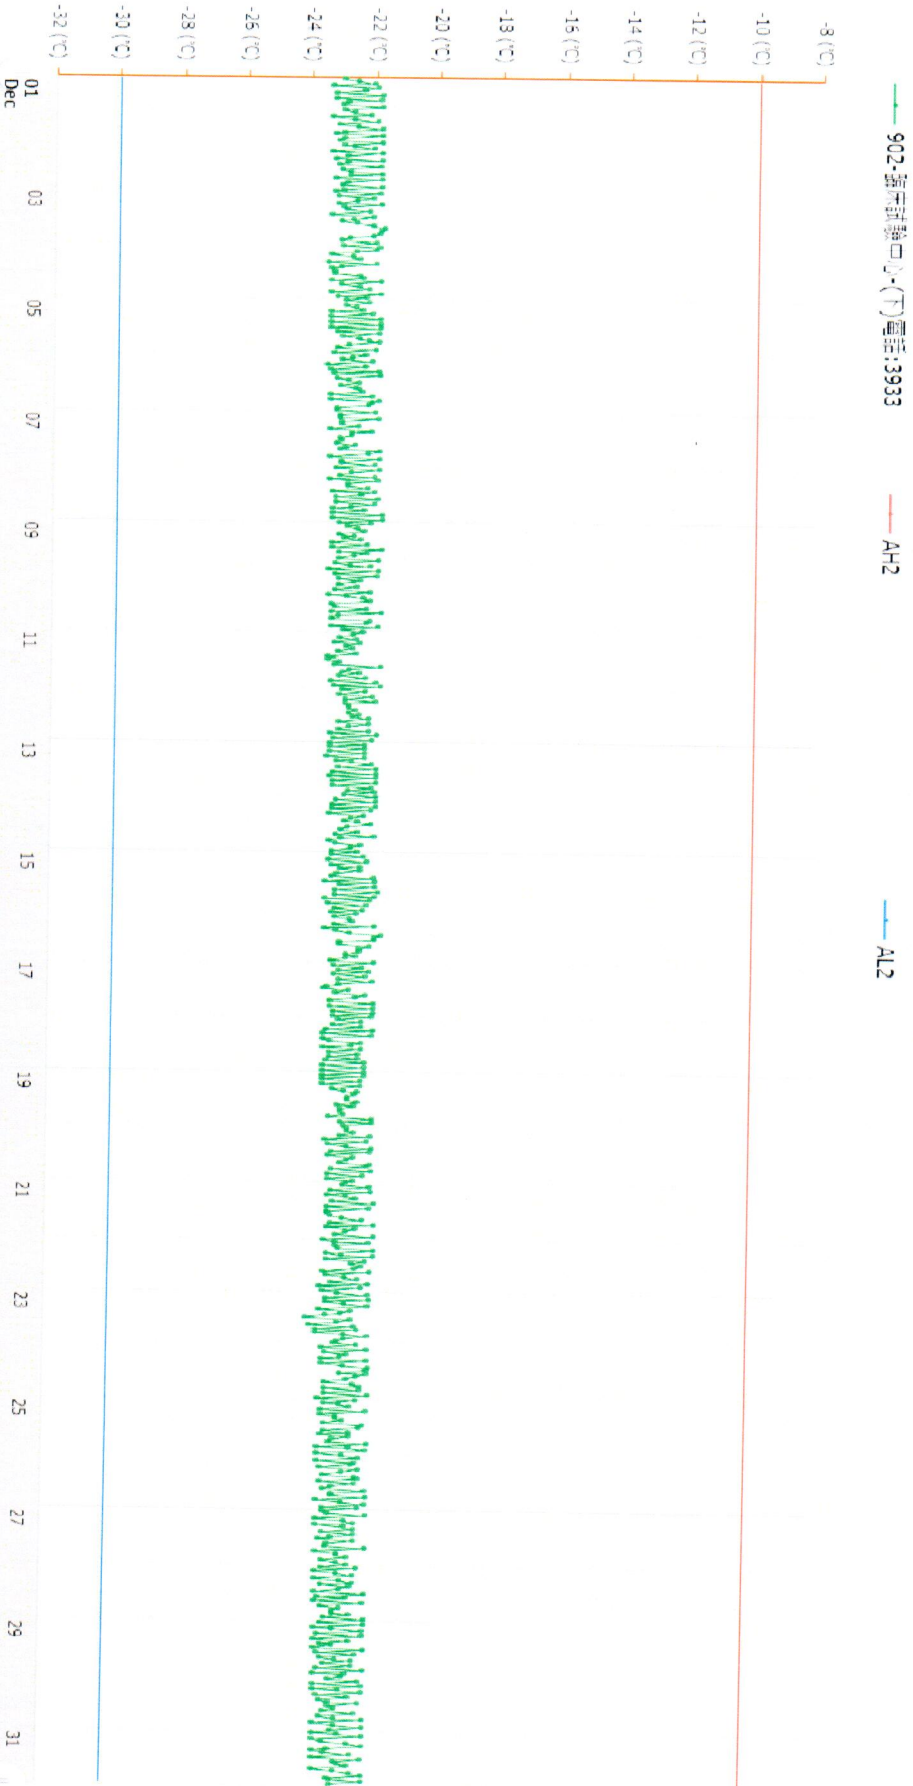

列印時間：

2021-01-05 15:15:50

單位主管：

許淑英
2021.01.05

製表者：

黃千琴

2021.01.05