


點位：

902-臨床試驗中心-(下)電話:3933

時間：

2021-11-01 00:00:00 - 2021-11-30 23:59:59

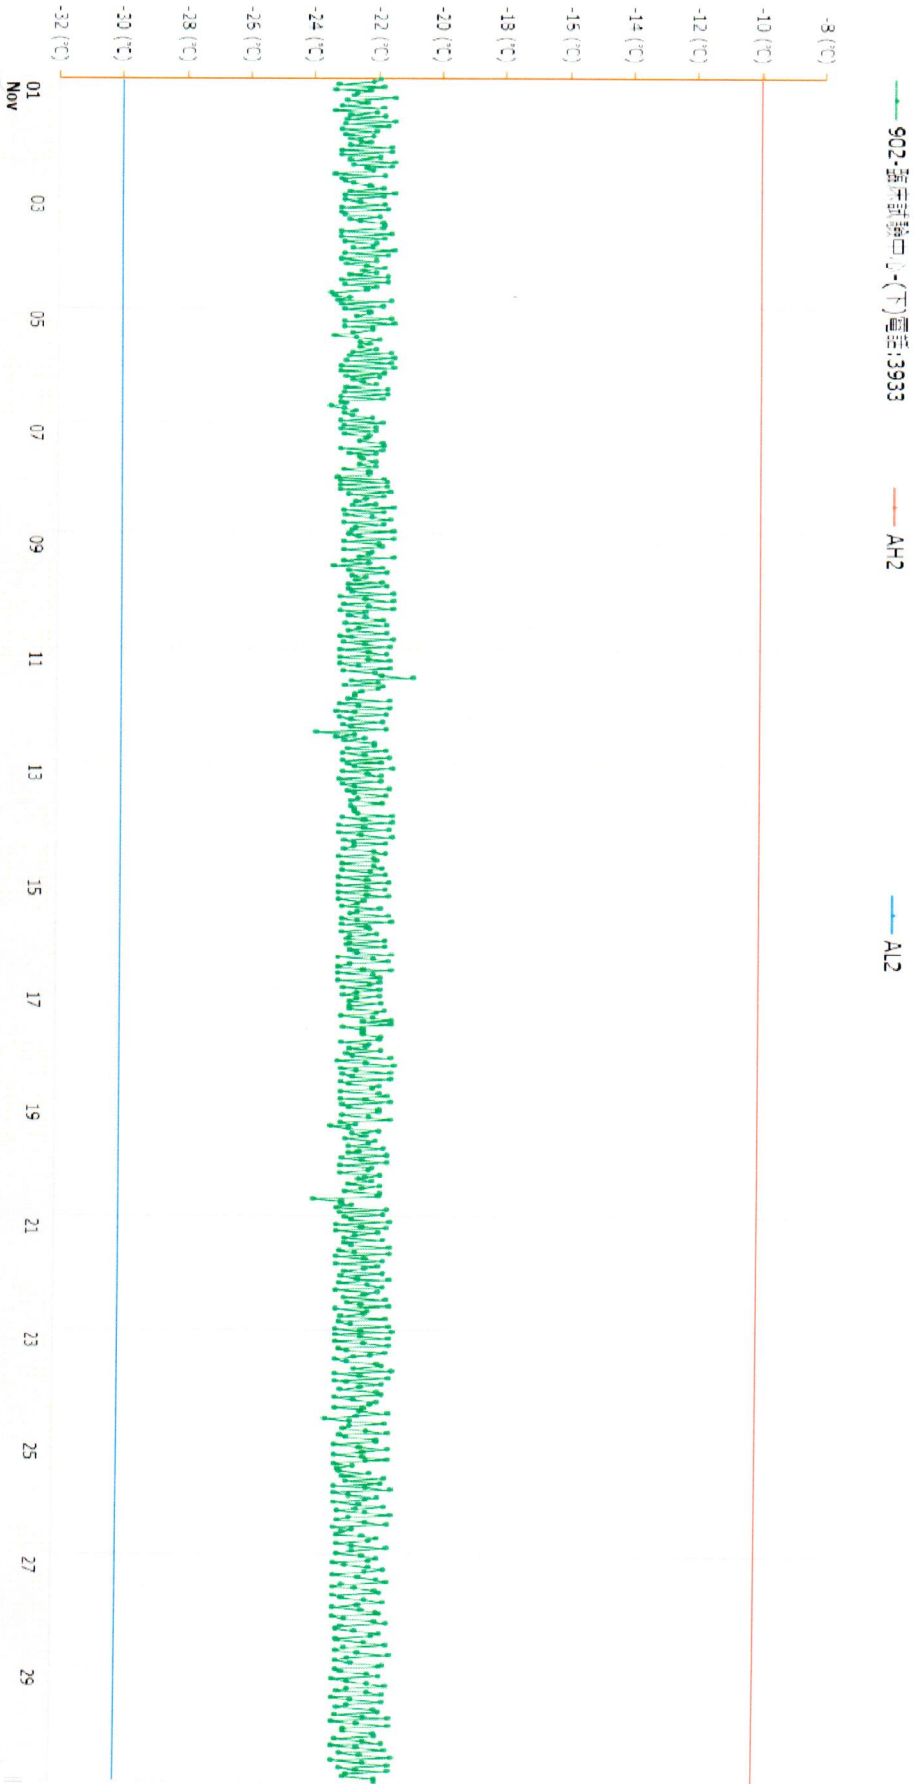

列印時間：

2021-12-01 08:43:22

單位主管：

許淑曼  
2021.12.02

製表者：

黃子馨  
31-Dec-2021