


點位：	902-臨床試驗中心-(下)電話:3933	時間：	2021-12-01 00:00:00 - 2021-12-31 23:59:59
-----	-----------------------	-----	---

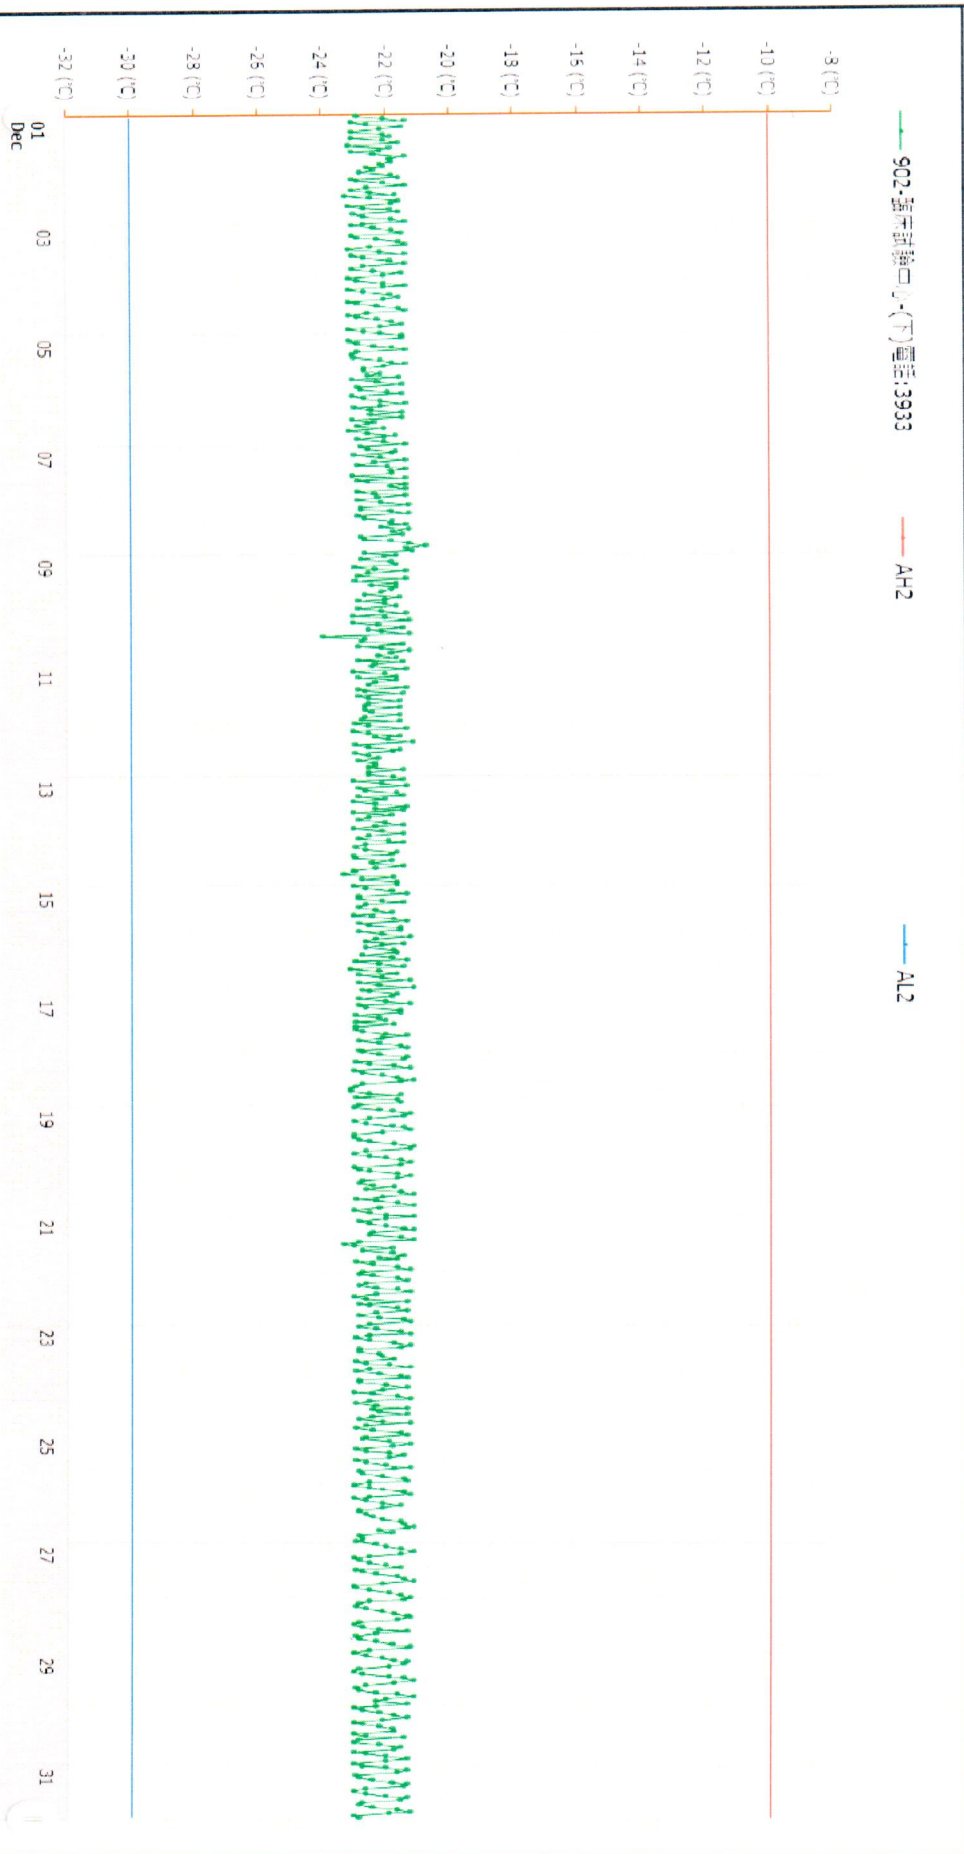

列印時間：	2022-02-07 09:51:41	單位主管：	許淑曼	製表者：	黃子樑
			2022.02.07		21 Feb 2022