


點位：	902-臨床試驗中心-(下)電話:3933	時間：	2022-10-01 00:00:00 - 2022-10-31 23:59:59
-----	-----------------------	-----	---

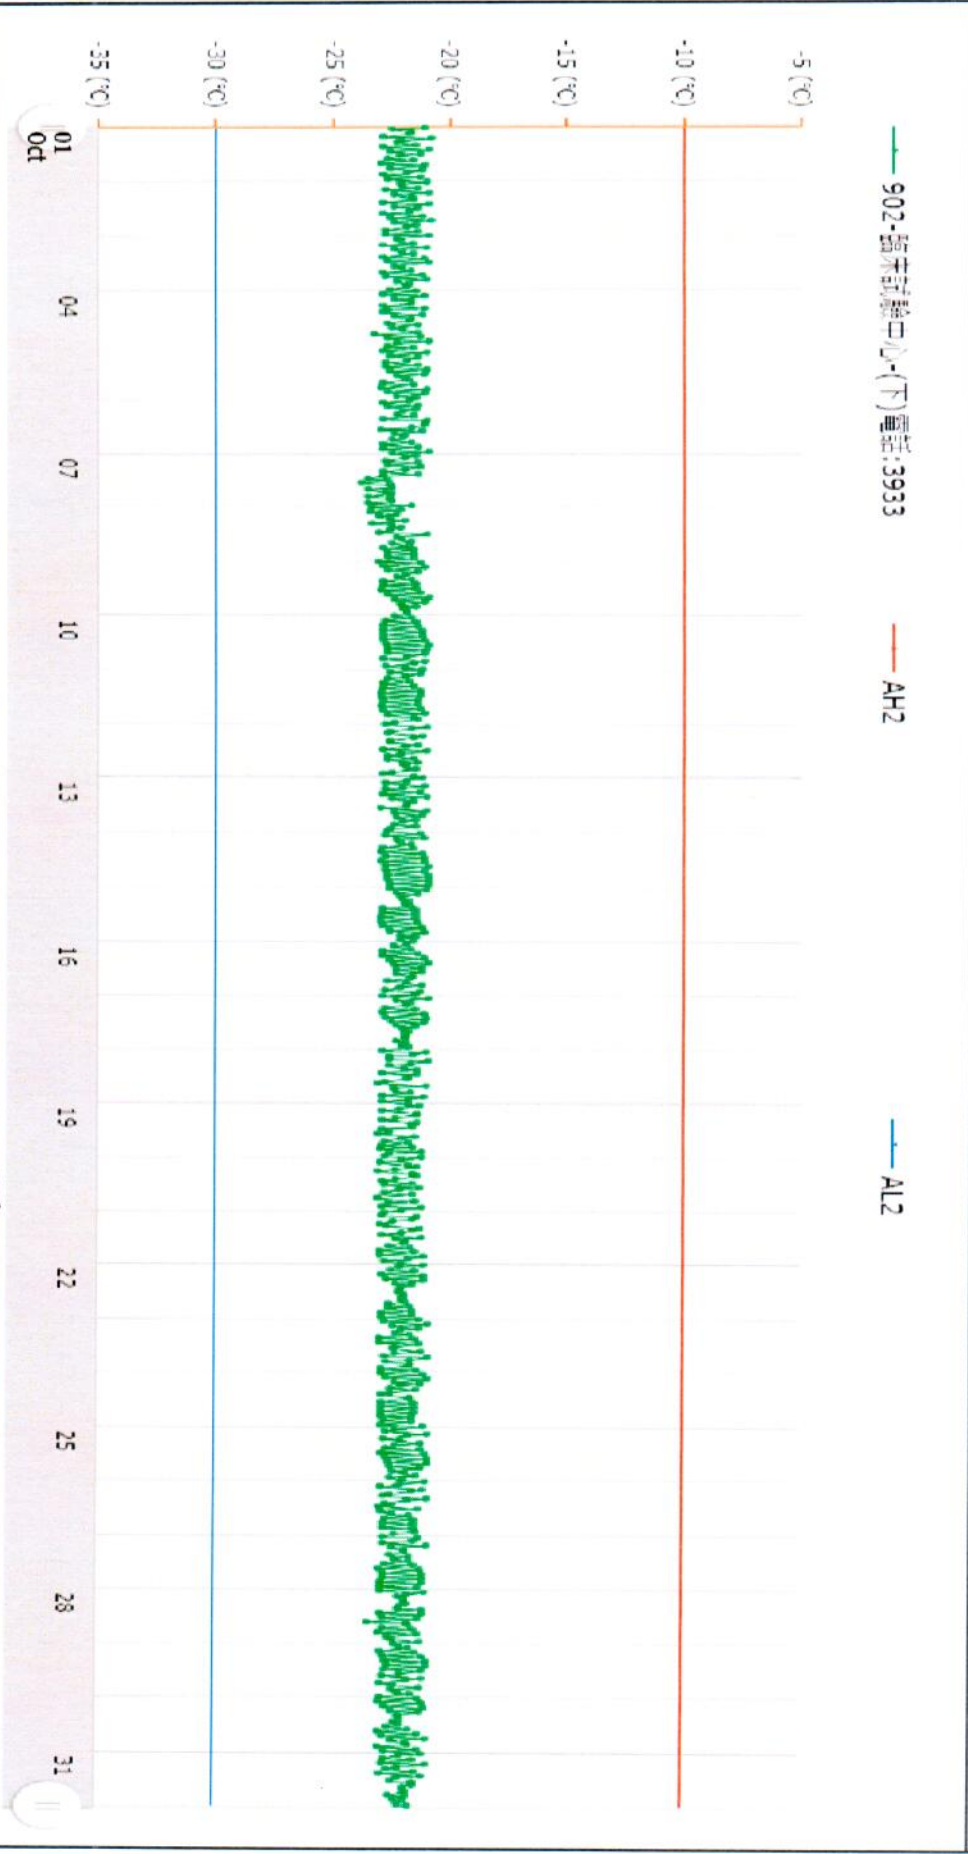

列印時間：	2022-11-01 10:40:52	單位主管：	黃子榮	製表者：	黃子榮
			2022-11-01		01, NOV, 2022