


點位：

902-臨床試驗中心(下)電話:3933

時間：

2022-11-01 00:00:00 - 2022-11-30 23:59:59

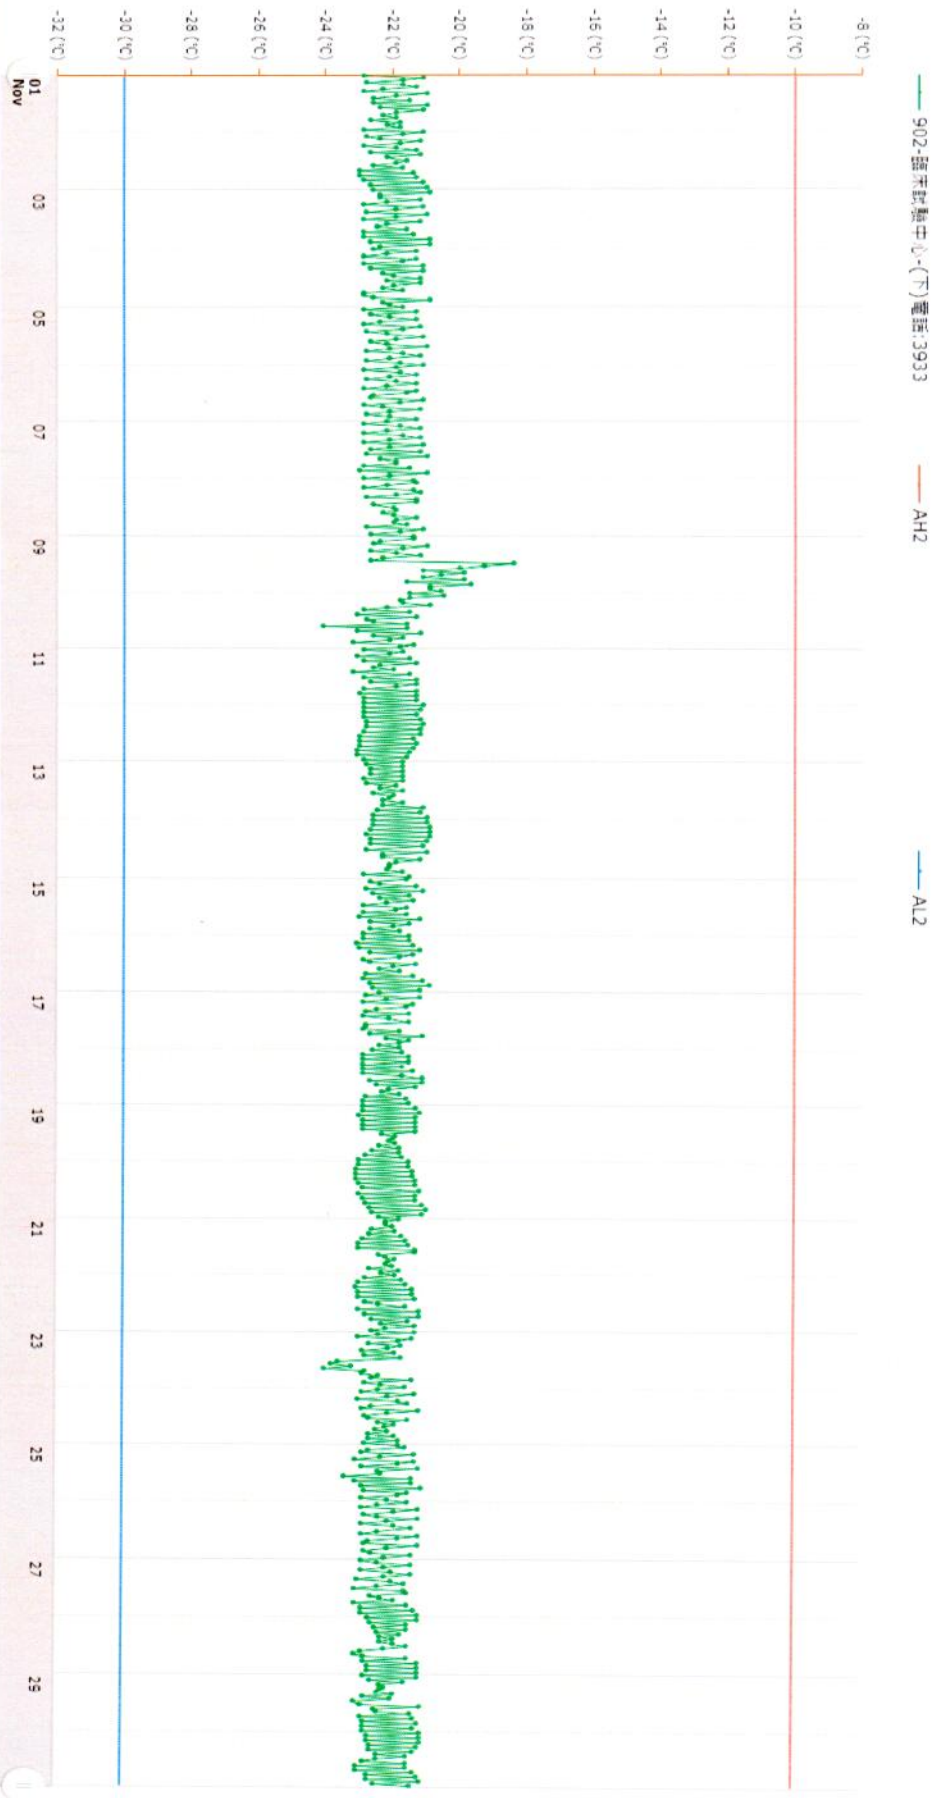

列印時間：

2022-12-01 15:55:00

單位主管：

許淑英  
2022.12.01

製表者：

黃子馨  
外、DCC、222