


點位：

902-臨床試驗中心-(下)電話:3933

時間：

2023-01-01 00:00:00 - 2023-01-31 23:59:59

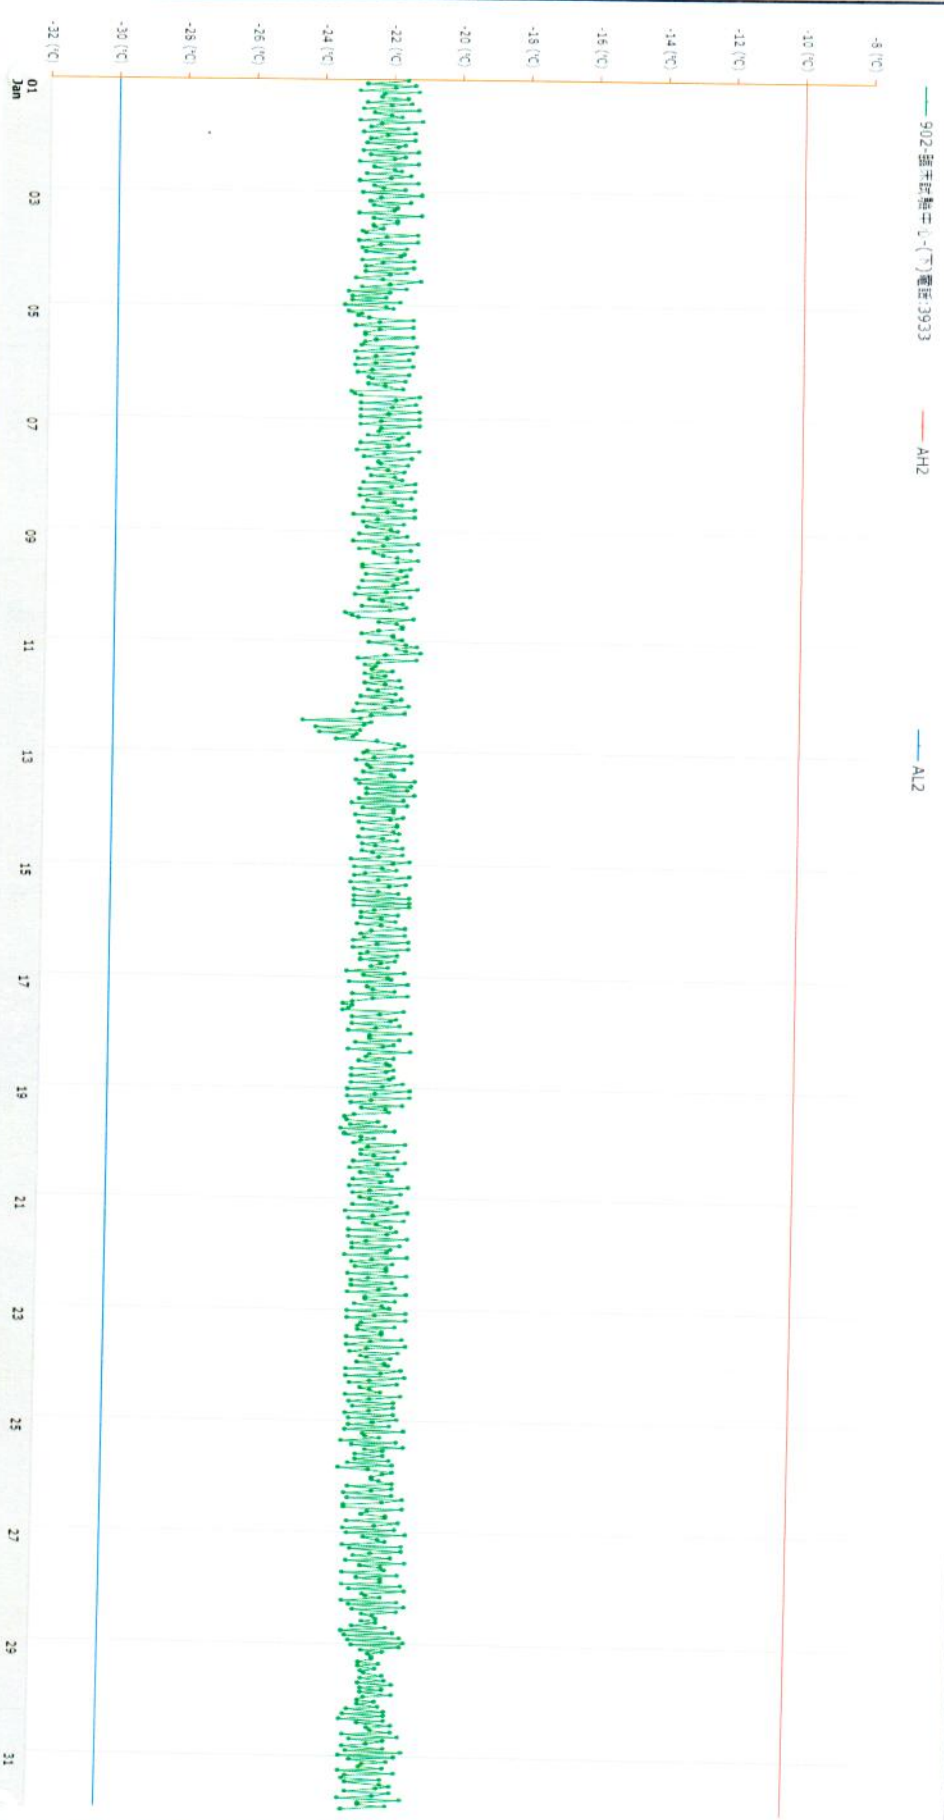

列印時間：

2023-02-01 10:11:15

單位主管：

許淑曼  
2023.02.01

製表者：

01-Feb. 2023