

監控點圖表


監控點: 902-臨床試驗中心-(下)電話:3933

時間區間: 2023-02-01 00:00 ~ 2023-02-28 23:59

最大值: -20.9 °C

最小值: -24.6 °C

平均值: -22.1 °C

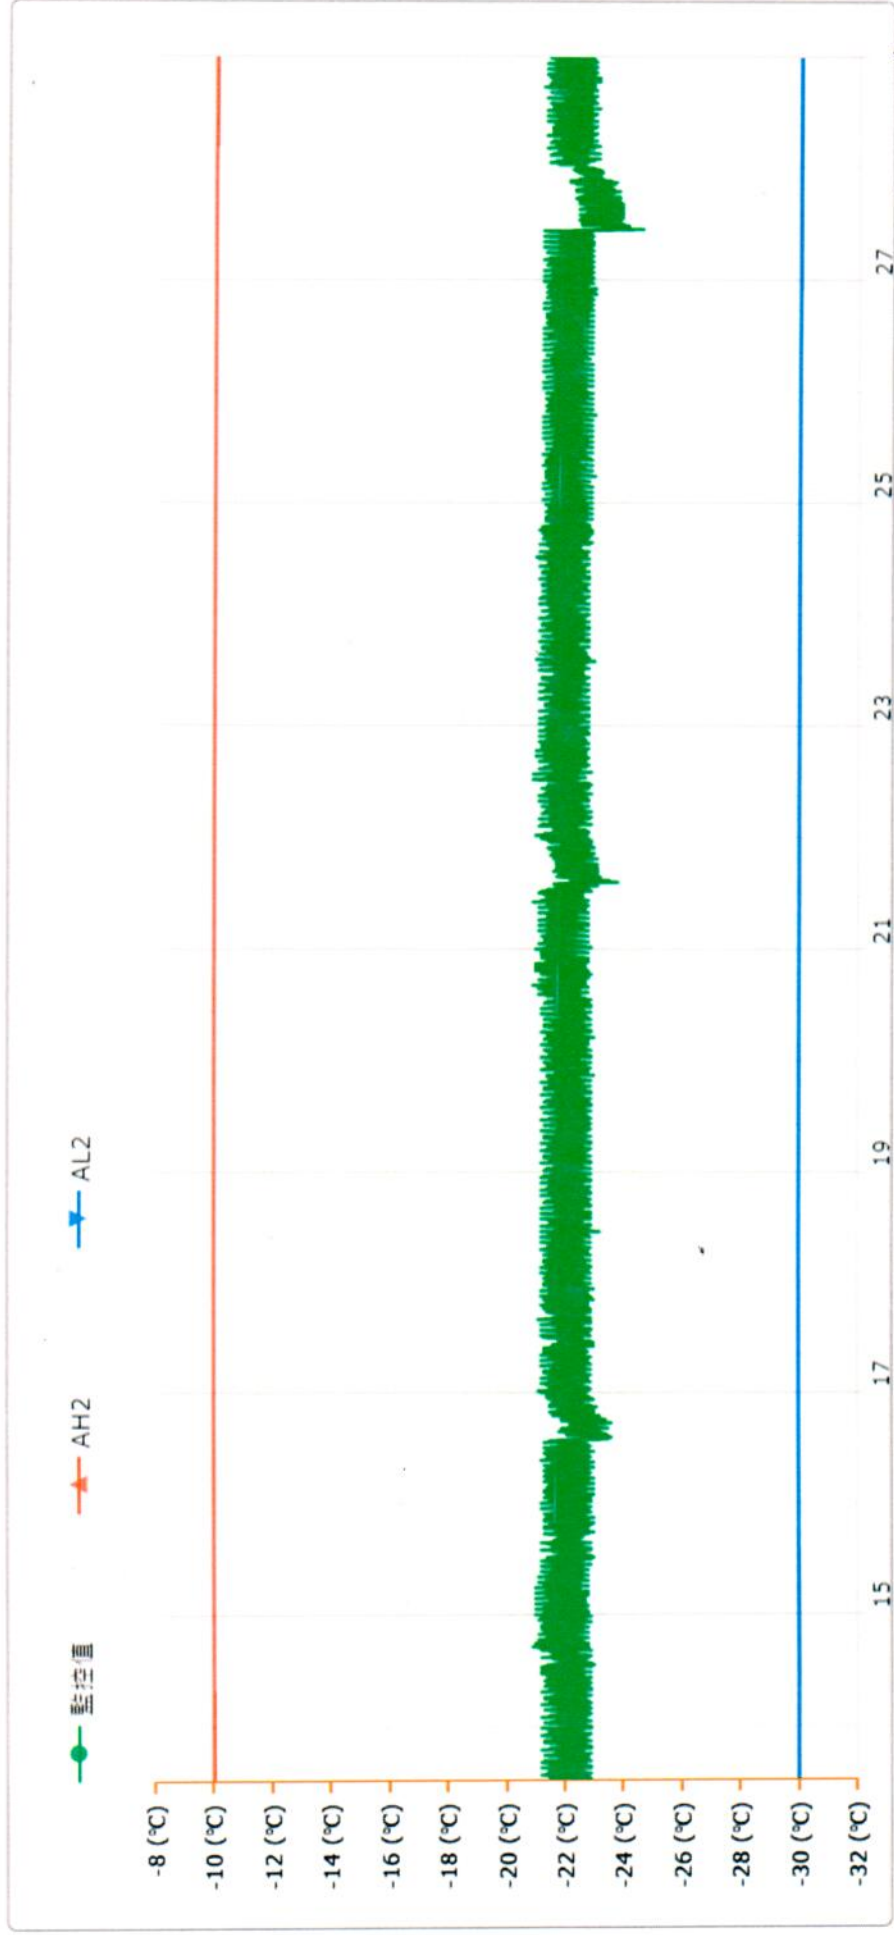

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管: 許景文

2023.05.16 re-sign, due to electric system have some error change for 2023.07.01