

# 監控點圖表


監控點: 902-臨床試驗中心-(下)電話:3933

時間區間: 2023-03-01 00:00 ~ 2023-03-31 23:59

最大值: -20.9 °C

最小值: -25.2 °C

平均值: -22.2 °C

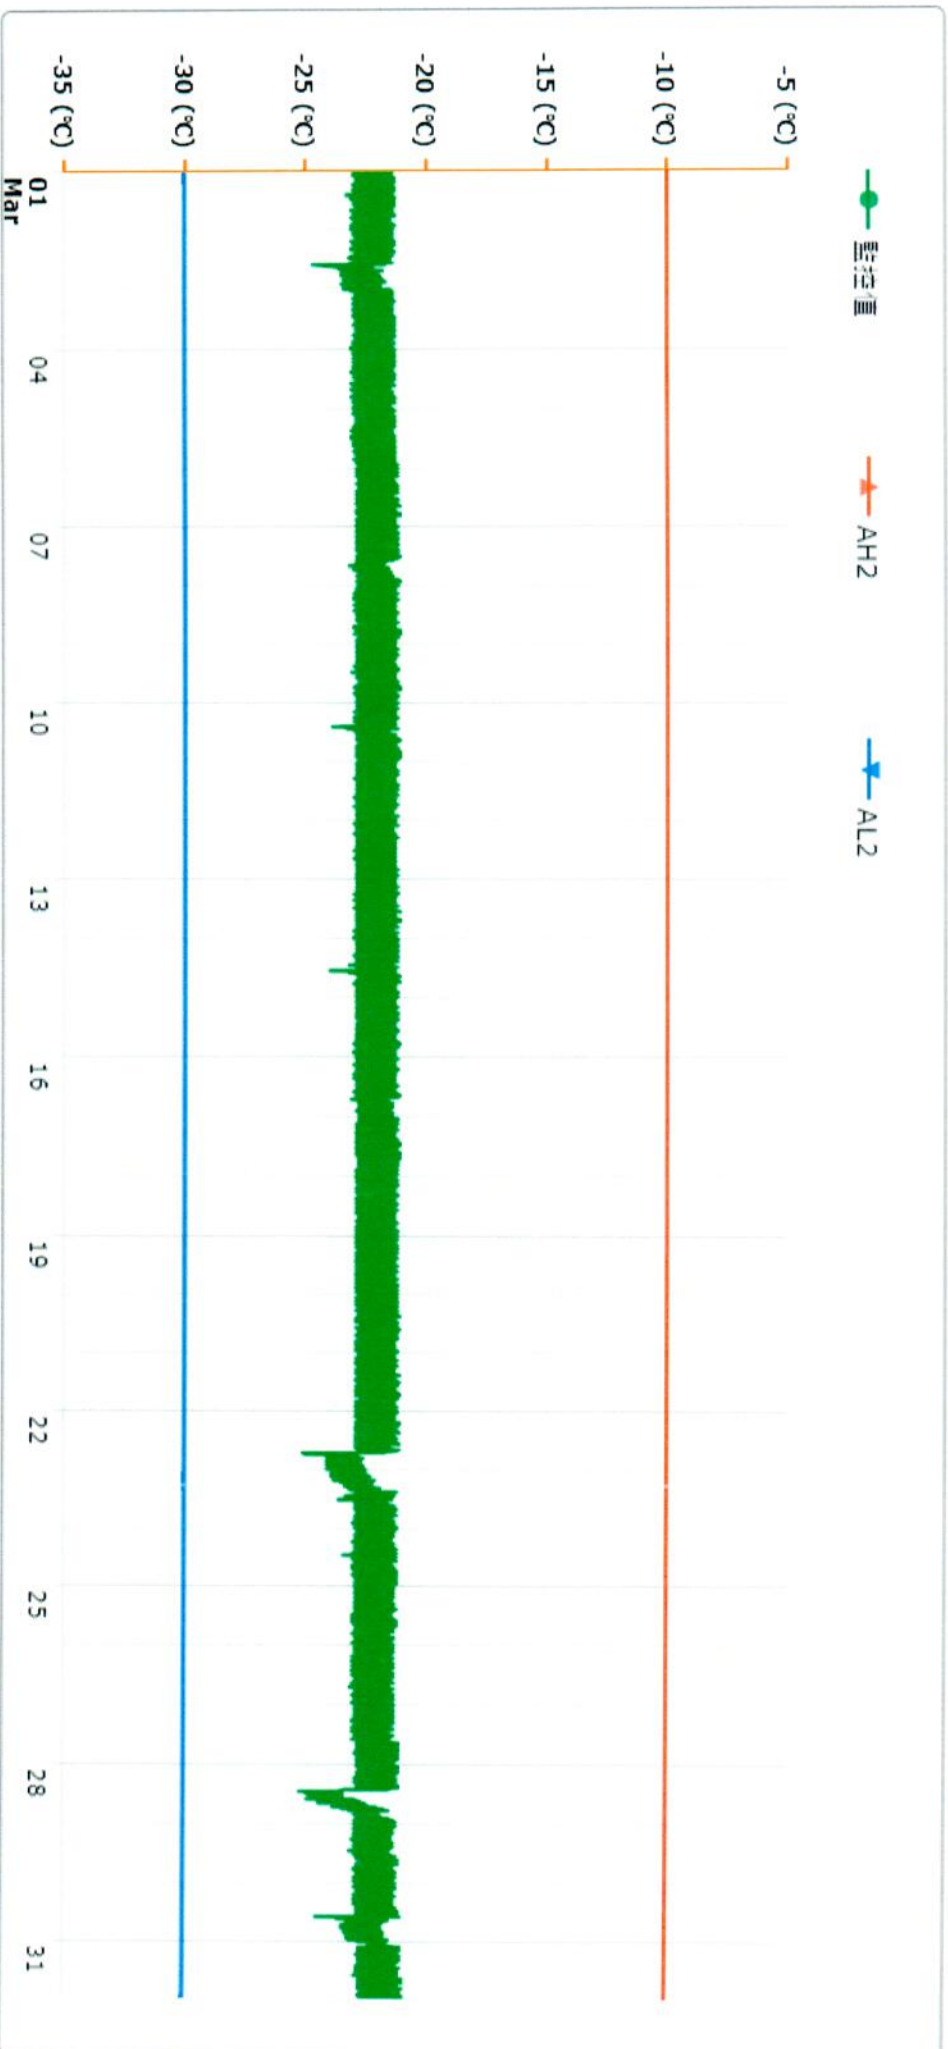

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑貞 2023.04.09