

監控點圖表


監控點: 902-臨床試驗中心-(下) 電話: 3933

時間區間: 2023-10-01 00:00 ~ 2023-10-31 23:59

最大值: -20.3 °C

最小值: -24.3 °C

平均值: -22.0 °C

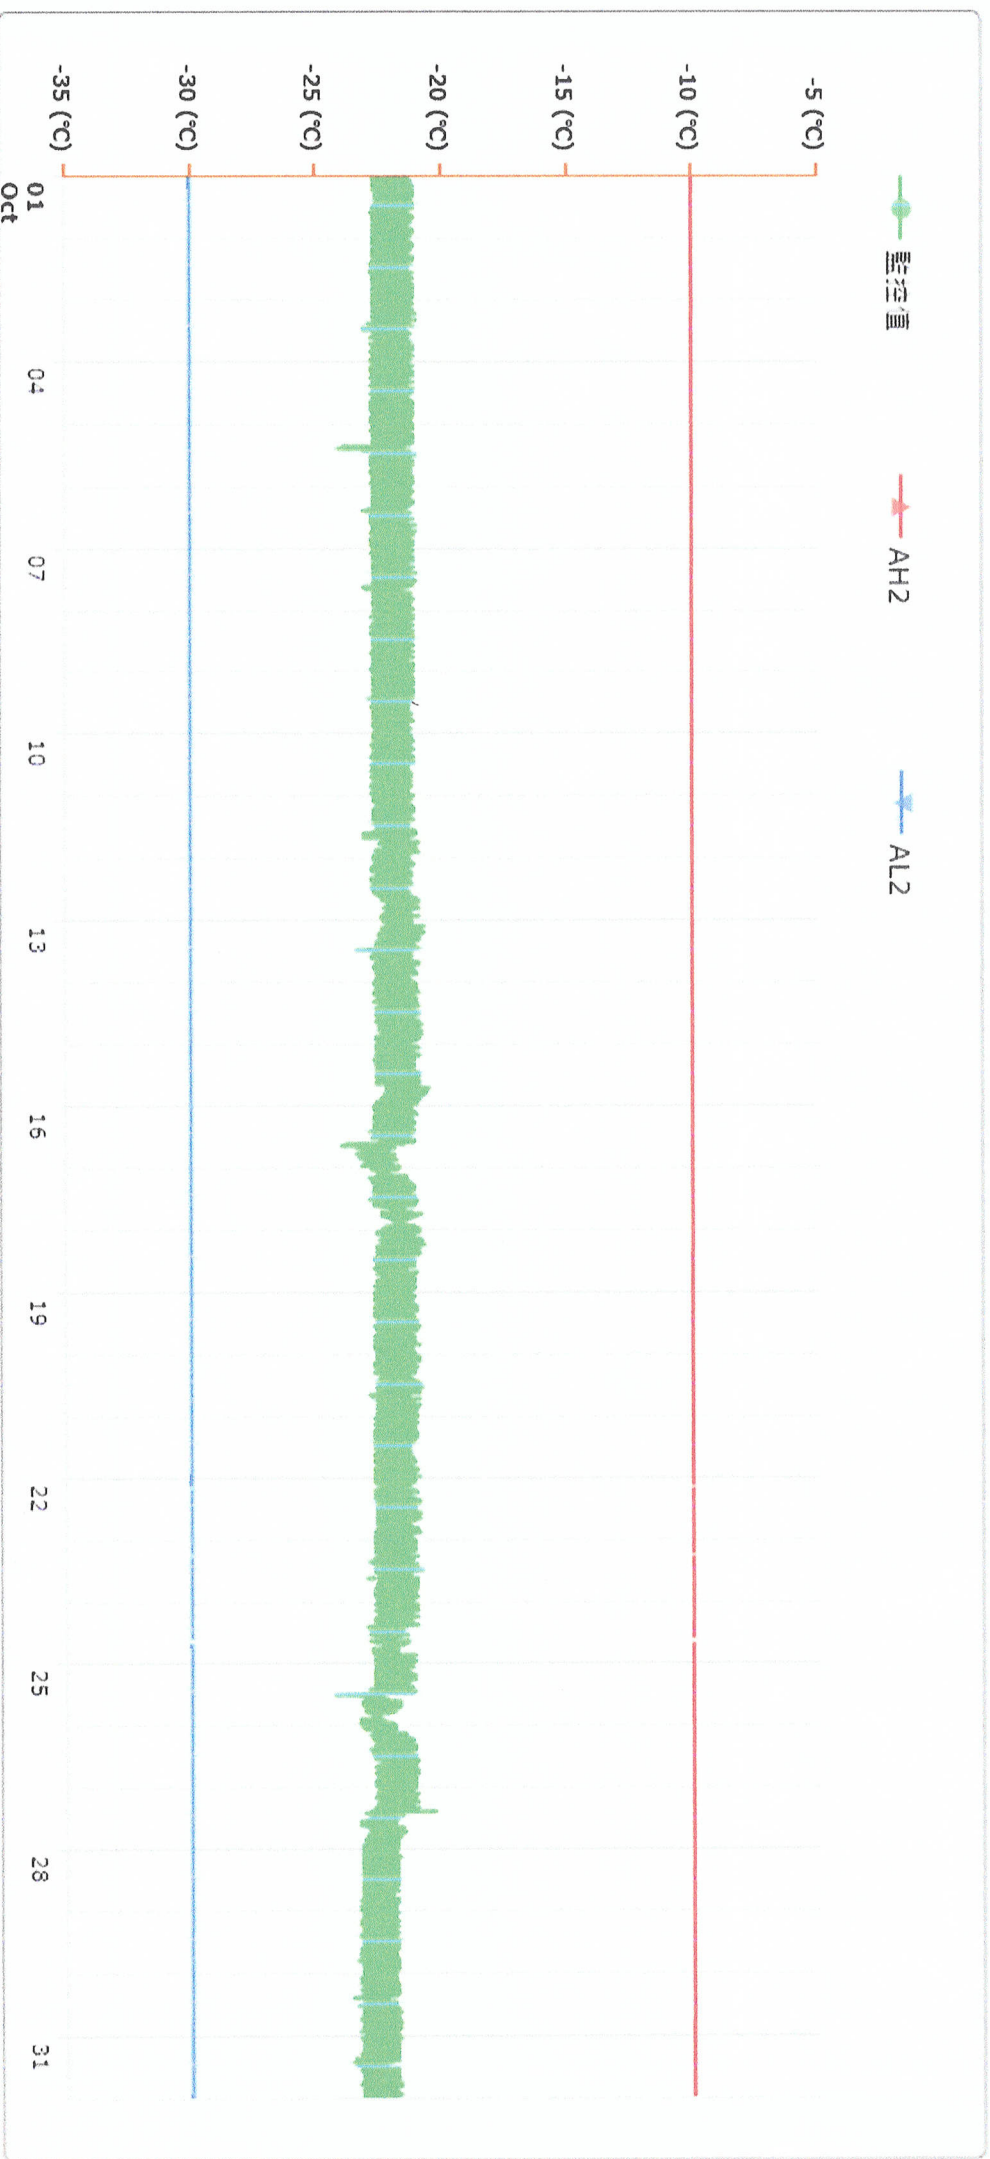

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑曼 2023.11.02